


Dr. MARIO DE LA PIERRE

T O R I N O


VIA DEI MILLE, N. 16

Forniture complete per laboratori biologici e batteriologici

Nuovo Emojo metro per la determinazione a lettura diretta e rapida dei valori pH. nel sangue circolante.

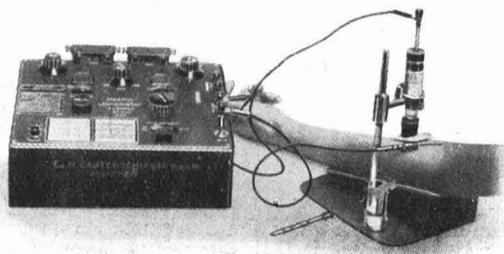

Centrifughe originali sistema Lundgren, ad altissimo rendimento. Solo con queste centrifughe è resa superflua la taratura dei tubi: modelli da 4 e 12 tubi da cc. 15; a 6 tubi da cc. 50; a 27 tubi da cc. 8 (Wassermann).

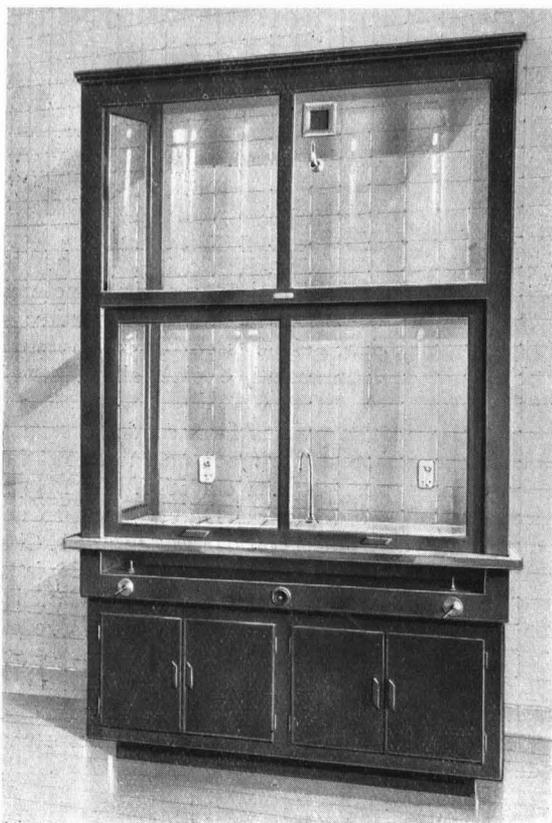

DITTA A. C. ZAMBELLI

SOCIETÀ ANONIMA

CORSO RAFFAELLO 20 - TEL. 61.717

T O R I N O



**ARREDAMENTI
E
FORNITURE COMPLETE
PER
LABORATORI SCIENTIFICI**